F.D.

REPORT NO. 2205 SCAN

CHAN# 8 METHOD: SCAN SAMPLE: ~~E 501~~ 1016 - 75.6mg.

MIN AR	MV/M	DLY	DVT	DIL-FTR%
250	.300	1.00	0.00	100.00

RT	ITM	AREA	%	NAME
1.36		456 BV	7.985	
1.80		1034 VB	18.116	
2.13		1248 BV	21.854	
3.04		1387 BV	24.299	
3.41		1584 VB	27.745	

TOTAL AREA = 5710

DSW 298705

REPORT NO. 2206 SCAN

CHAN# 8 METHOD: SCAN SAMPLE: WCM STG4

MIN AR	MV/M	DLY	DVT	DIL-FTR%
250	.300	1.00	0.00	100.00

FID.

ENDED NOT ON BL

RT	ITM	AREA		%	NAME
1.33		73194	BV	.381	
1.56		33777	VV	.176	
1.68		59935	VV	.312	
2.06		542117	VV	2.823	
2.52		842490	VV	4.388	
3.32		2473	VV	.013	
4.48		215364	VV	1.122	
5.45		103903	VV	.541	
6.15		1893	VV	.010	
6.83		4117	VV	.021	
7.69		35863	VV	.187	
8.55		24888	VV	.130	
9.68		199144	VV	1.037	
10.37		402252	VV	2.095	
11.10		447501	VV	2.331	
11.77		1516804	VV	7.900	
12.45		492233	VV	2.564	
12.69		1219852	VV	6.353	
13.24		749243	VV	3.902	
13.63		882824	VV	4.598	
13.94		2504509	VV	13.044	
14.57		3761677	VV	19.591	
15.02		985008	VV	5.130	
15.64		429916	VV	2.239	
16.18		579304	VV	3.017	
16.50		230855	VV	1.202	
17.03		997861	VV	5.197	
17.59		922781	VV	4.806	
18.39		445198	VV	2.319	
18.79		397666	VV	2.071	
19.69		96508	VF	.503	

TOTAL AREA = 192011152

DSW 298706

KE 7 X 10 INCHES MADE IN U.S.A.
KEUFFEL & ESSER CO.

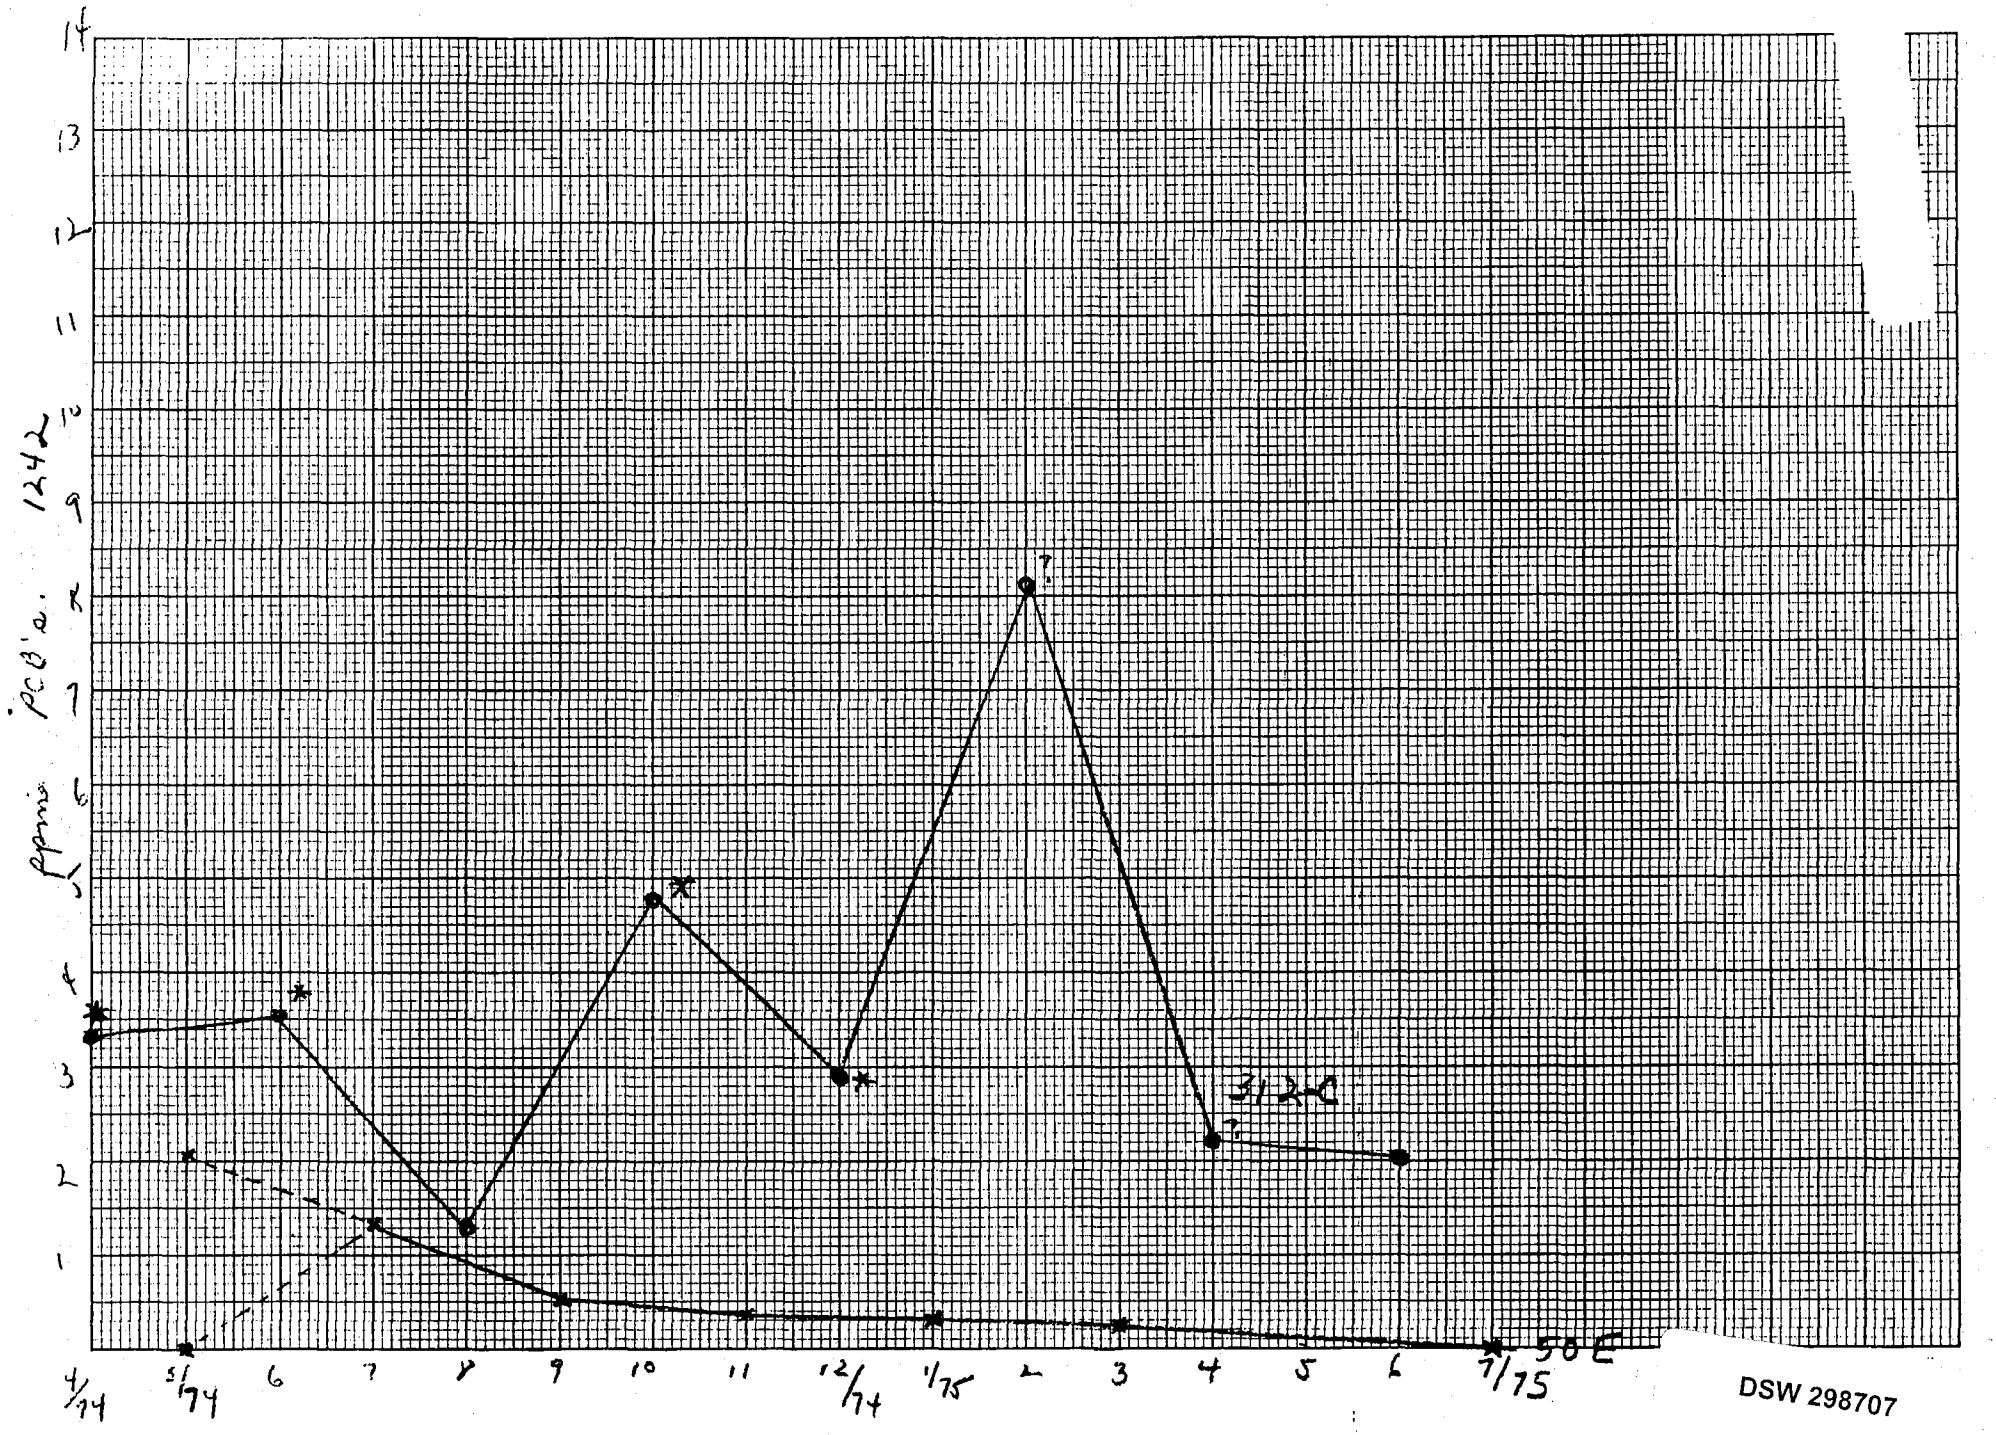

[redacted]

STLCOPCB4068620

KLUFFEL & ESSER CO.

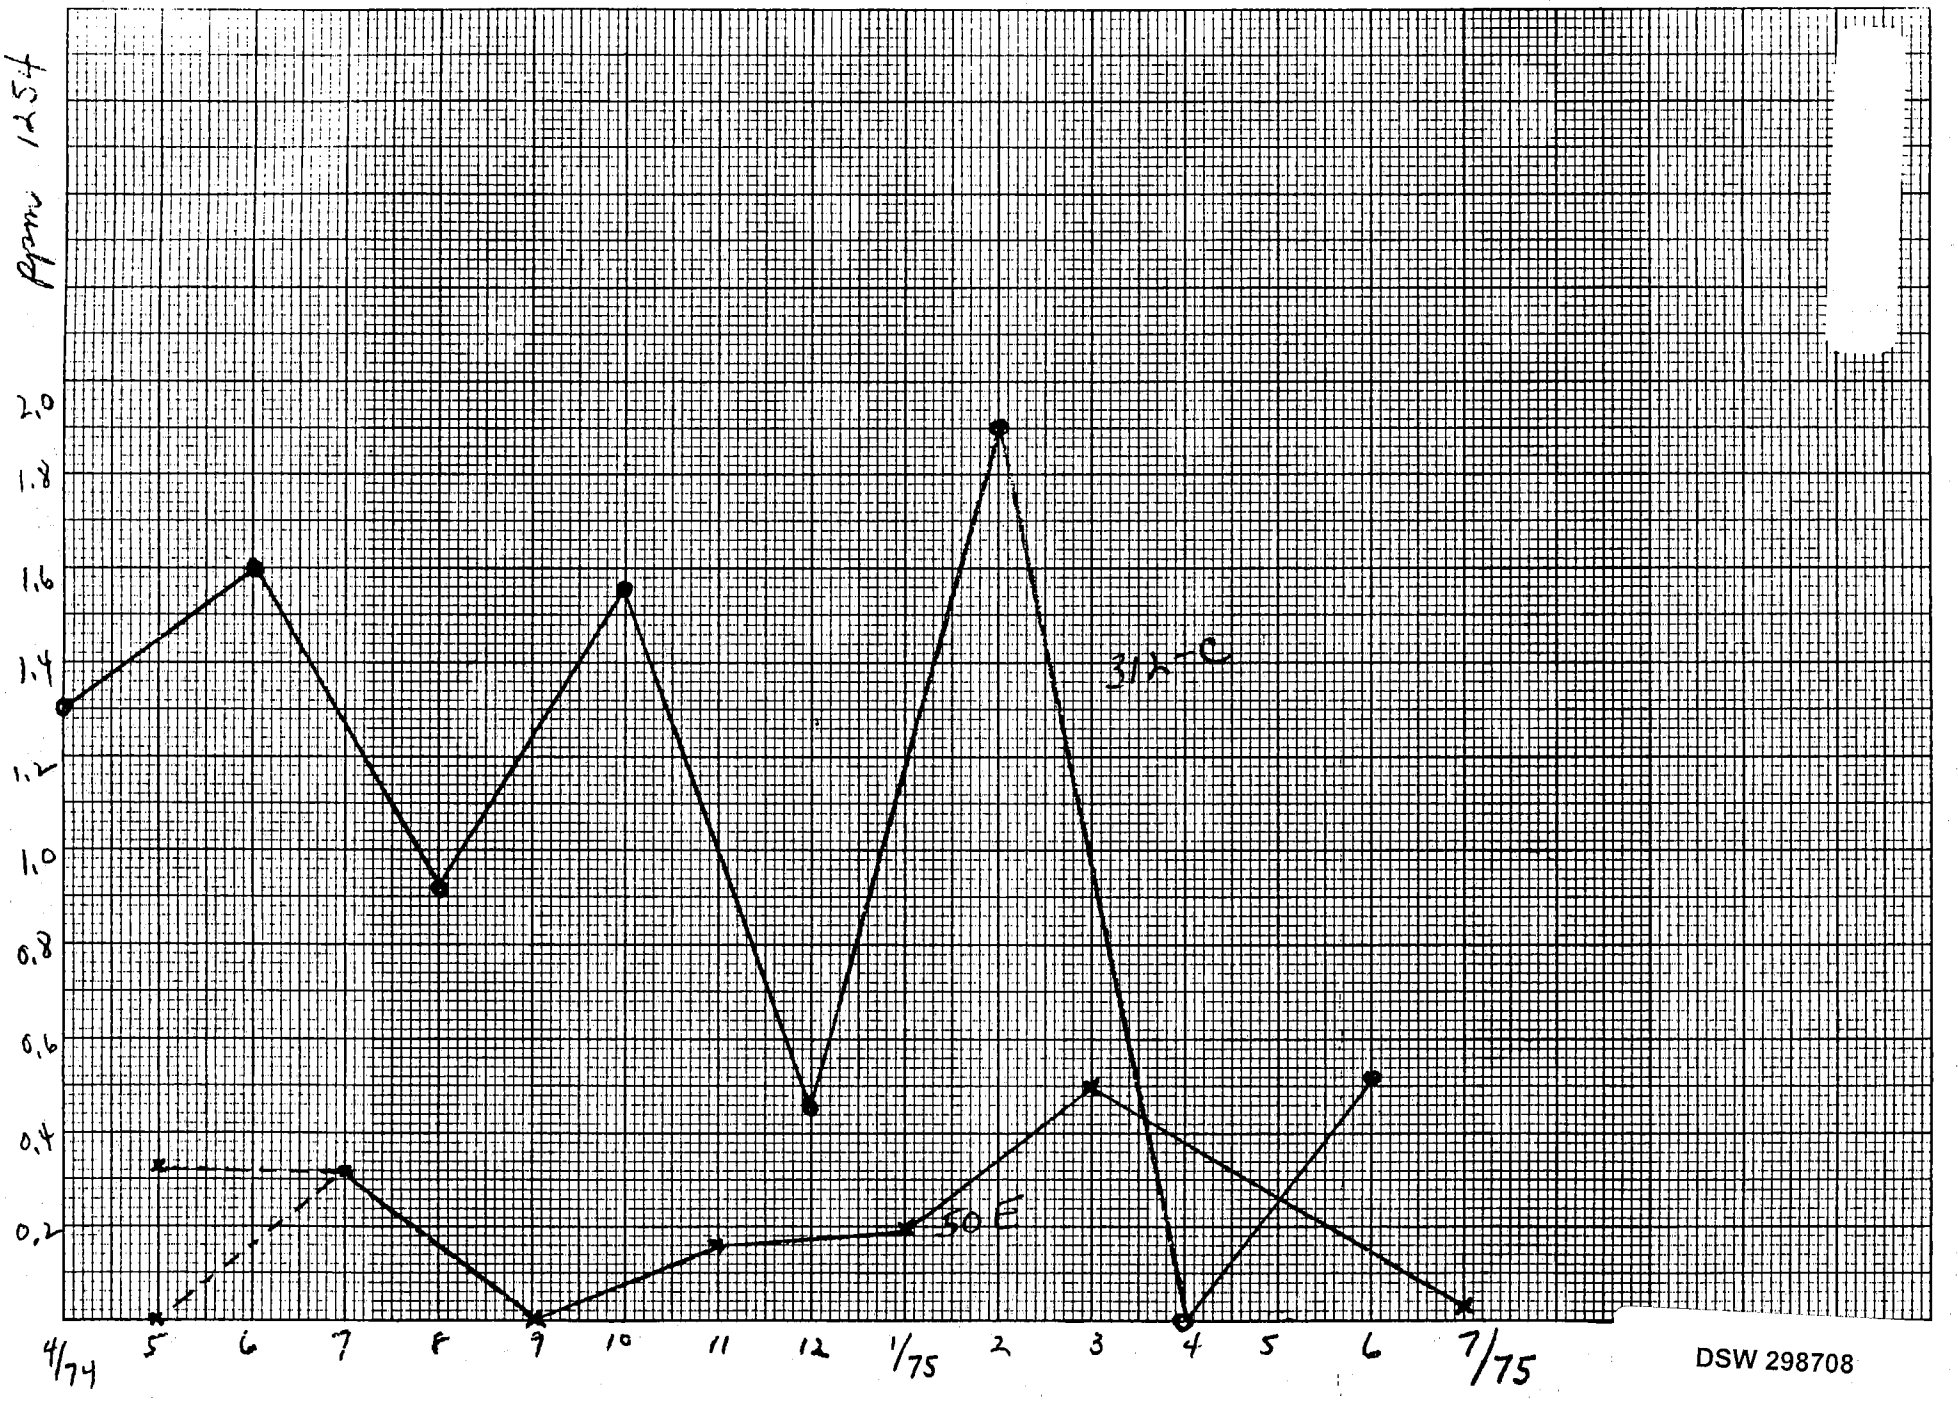

DSW 298708

STLCOPCB4068621